

Quick-Start


Geratherm[®]
non Contact

1.




Einschalten ...

2.




... 4 Sek. warten.



Einstellung  (Stirn) wählen.

3.

ca. 2 cm



Vor der Stirn positionieren.


4.



Messung starten.

5.

3 Sekunden

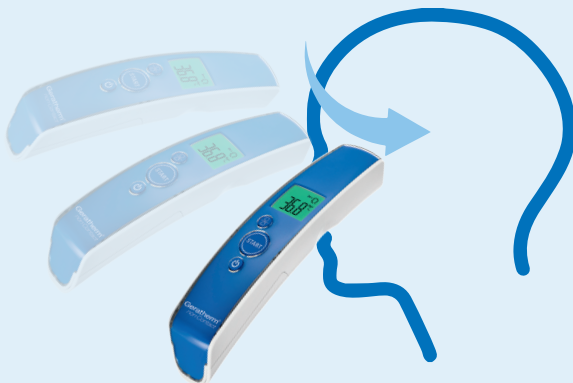

Der Kopfform bis zur Schläfe folgen.

6.

beep 

Messung abgeschlossen.